



- |           |                          |           |                                  |           |                              |           |  |
|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--|
| <b>EN</b> | 1. Probe                 | <b>ES</b> | 1. Punta                         | <b>DE</b> | 1. Schutzhülle               | <b>FR</b> | 1. Probe                                     |
|           | 2. Measuring Trigger     |           | 2. Gatillo mecánico              |           | 2. Mess-Auslöser             |           | 2. Gâchette de mesure                        |
|           | 3. Strap                 |           | 3. Correa                        |           | 3. Riemen                    |           | 3. Sangle                                    |
|           | 4. Backlight LCD Display |           | 4. Pantalla LCD con luz de fondo |           | 4. Hinterleuchte LCD-Anzeige |           | 4. Affichage LCD rétroéclairé d'annonce      |
|           | 5. ON/OFF/Memory Button  |           | 5. Botón ON/OFF/Memory           |           | 5. On/Off/Speicher Taste     |           | 5. Bouton ON/OFF/Mémoire                     |
|           | 6. Selecting Zone        |           | 6. Selector de zona              |           | 6. Wahlbereich               |           | 6. Zone de Sélection (Zone de programmation) |
|           | 7. Battery Cover         |           | 7. Tapa de pila                  |           | 7. Batterieabdeckung         |           | 7. Couverture de piles                       |

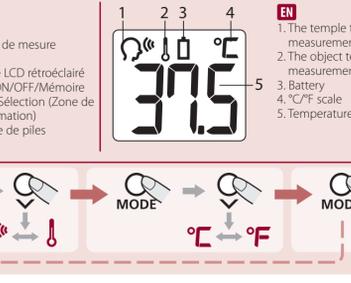

- |           |  |           |  |           |  |           |   |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|---|
| <b>EN</b> | 1. The temple temperature measurement mode | <b>ES</b> | 1. El modo de medición de temperatura en la sien | <b>DE</b> | 1. Modus zum Messen der Schläfe          | <b>FR</b> | 1. Le mode de mesure de la température des tempes |
|           | 2. The object temperature measurement mode |           | 2. El modo de medición de temperatura de objetos |           | 2. Modus zum Messen der Objekttemperatur |           | 2. Mode de mesure de la température Objet         |
|           | 3. Battery                                 |           | 3. Batería                                       |           | 3. Batterie                              |           | 3. Pile   |
|           | 4. °C/°F scale                             |           | 4. °C/°F scale                                   |           | 4. Escala de °C/°F                       |           | 4. Échelle °C/°F                                  |
|           | 5. Temperature display                     |           | 5. Temperature display                           |           | 5. Temperaturanzeige                     |           | 5. Affichage de la température                    |

- |           |  |           |  |           |  |           |   |
|-----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|---|
| <b>EN</b> | 1. The temple temperature measurement mode | <b>ES</b> | 1. El modo de medición de temperatura en la sien | <b>DE</b> | 1. Modus zum Messen der Schläfe          | <b>FR</b> | 1. Le mode de mesure de la température des tempes |
|           | 2. The object temperature measurement mode |           | 2. El modo de medición de temperatura de objetos |           | 2. Modus zum Messen der Objekttemperatur |           | 2. Mode de mesure de la température Objet         |
|           | 3. Battery                                 |           | 3. Batería                                       |           | 3. Batterie                              |           | 3. Pile   |
|           | 4. °C/°F scale                             |           | 4. °C/°F scale                                   |           | 4. Escala de °C/°F                       |           | 4. Échelle °C/°F                                  |
|           | 5. Temperature display                     |           | 5. Temperature display                           |           | 5. Temperaturanzeige                     |           | 5. Affichage de la température                    |



- |           |                          |           |                                  |           |                              |           |  |
|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--|
| <b>EN</b> | 1. Probe                 | <b>ES</b> | 1. Punta                         | <b>DE</b> | 1. Schutzhülle               | <b>FR</b> | 1. Probe                                     |
|           | 2. Measuring Trigger     |           | 2. Gatillo mecánico              |           | 2. Mess-Auslöser             |           | 2. Gâchette de mesure                        |
|           | 3. Strap                 |           | 3. Correa                        |           | 3. Riemen                    |           | 3. Sangle                                    |
|           | 4. Backlight LCD Display |           | 4. Pantalla LCD con luz de fondo |           | 4. Hinterleuchte LCD-Anzeige |           | 4. Affichage LCD rétroéclairé d'annonce      |
|           | 5. ON/OFF/Memory Button  |           | 5. Botón ON/OFF/Memory           |           | 5. On/Off/Speicher Taste     |           | 5. Bouton ON/OFF/Mémoire                     |
|           | 6. Selecting Zone        |           | 6. Selector de zona              |           | 6. Wahlbereich               |           | 6. Zone de Sélection (Zone de programmation) |
|           | 7. Battery Cover         |           | 7. Tapa de pila                  |           | 7. Batterieabdeckung         |           | 7. Couverture de piles                       |

**EN English Introduction**  
Rossmax non-contact temperature thermometer uses an infrared detector to detect body temperature from the temple temperature for adult and child in the hospital, home or public place. This thermometer could also detect object temperature.

The quality of the infrared temple temperature thermometer has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) Annex I essential requirements and applied harmonized standards. Comply with ASTM E1965-98(2016).

This thermometer converts the temple temperature to display its "oral equivalent" (according to the result of the clinical evaluation).

Please read the instruction manual carefully before using the product and be sure to keep this manual.

<b>Function</b>	The thermometer has been designed for practical use. It is not meant to replace a visit to the doctor. Please also remember to compare the measurement result to your regular body temperature.
<b>Temple Temperature</b>	The object mode shows the actual, unadjusted surface temperatures, which is different from the body temperature. It can help you to measure any object other than body surface, for example the baby's milk.
<b>Object Mode</b>	If thermometer detects a surface temperature >37.5°C (99.5°F) there will be four beeps sound with flashing reading to warn the user for potential fever.

**Setting your thermometer**  
1. Open the battery cover.  
2. Press "ON/OFF/Memory" button to power on the device.  
3. Enter the setting mode by pressing the "MODE" button to switch Temple/Object temperature, Celsius/Fahrenheit scale, and adjust beep sound in order.

4. Change the measuring target between the temple and object by pressing the "Q" button. After setting a new measuring target, the measuring site icon on the display will also be switched accordingly.  
5. Change the "C" and "F" by pressing the "MODE" button again to enter the setting mode. Press the "Q" button to switch the corresponding measuring scale. The measuring site icon on the display will also be switched accordingly after a new measuring scale is set.  
6. After adjusting measuring target and scale, press the "MODE" button again to move to the next setting of beep sound.  
7. Adjust beep sound as described above, using the "Q" button to choose whether beep sound is activated (b1/on) or deactivated (b1/DF).

8. Your thermometer is ready for measurement after all symbols appear or pressing ON/OFF/Memory button again.  
Note:  
• The initial setting is Temple temperature mode, Celsius scale and beep sound activated as default.

**How to measure temple temperature**  
1. Always make sure the probe is clean, and without damage.  
2. Press "ON/OFF/Memory" button to turn on the device.  
3. Make sure the measuring site icon is shown on the display before taking measurement.  
4. Vertically aim the thermometer at the temple with a distance of less than 10 cm. If the temple is covered with hair, sweat or dirt, remove the obstacle from the temple to improve the measurement accuracy.  
5. Press the "Measuring Trigger" button to take temperature. Measurement is complete when you hear a long beep sound.  
6. Read the recorded temperature from the LCD display.

**How to measure object temperature**  
1. Press "ON/OFF/Memory" button to turn on the device.  
2. Do not take measurement while or immediately after nursing.  
2. Make sure the measuring site icon is shown on the display before taking measurement.  
3. Once aiming at the measured target, press the "Measuring Trigger" button to take temperature. Measurement is complete when you hear a long beep sound.  
4. Read the recorded temperature from the LCD display.  
Note:  
1. Applications include temperature measurements for Water, Milk, Cloth, Skin or other object.  
2. This mode shows the actual, unadjusted object temperatures, which is different from the body temperature.

**Memory function**  
There are total 9 set memories for measurement records. If the reading of the thermometers is within the normal temperature range of 34 °C to 42.2 °C (93.2 °F to 108 °F), when the measurement is done, the measurement data is saved into memory.  
• Press "ON/OFF/Memory" button to repeatedly recall each temperature memory.  
**Care and cleaning**  
1. Store the thermometer safely. It should be stored at room temperature between -25 ~ +55°C, (-13°F ~ 131°F) RH <85%, 700~1060hPa.  
2. Keep the unit dry and away from any liquids and direct sunlight.  
3. The probe should not be submerged into liquids.  
4. Please check the device if damaged once it falls. If you can't make sure of it, please send the complete device to the nearest retailer for re-calibration.  
5. Holding the thermometer too long may cause a higher ambient temperature reading of the probe. This could make the body temperature measurement lower than usual. Please try not to touch the thermometer probe part for avoiding the incorrect reading.  
**Installing Batteries**  
1. Open the battery cover: use thumb to push battery cover out.  
2. Install or replace 2 "AAA" sized batteries in the battery compartment according to the indications inside the compartment.  
3. Replace the batteries in pairs. Remove batteries when the unit is not in use for extended periods of time.  
4. Place back the battery cover.  
You need to replace the batteries when  
1. Low battery icon appears on the display.  
2. The ON/OFF/Memory button is pressed and nothing appears on the display.  
Caution:  
⚠ 1. Batteries are hazardous waste. Do not dispose them together with the household garbage.  
2. There are no user serviceable parts inside. Batteries or damage of old batteries are not covered by warranty.  
3. Use exclusively brand batteries. Always replace with new batteries together. Use batteries of the same brand and same type.

**Troubleshooting:**

Error Message	Problem	Solution
EE	The system is not functioning properly.	Unload the battery, wait for 1 minute and re-power it. If the message reappears, contact the retailer for service.

<b>EI</b>	Exceeding operating temperature range	Allow the thermometer to rest in a room for at least 30 minutes at room temperature: for temple temperature mode: Temperature taken is higher than +42.2°C (108°F) (2) In Object mode: Temperature taken is higher than 99.9°C (199.9°F)
<b>Hi</b>		Please select the target within specifications. If a malfunction still exists, please contact the retailer for service.
<b>Lo</b>		Please select the target within specifications. If a malfunction still exists, please contact the retailer for service.
<b>Low Battery</b>	Device can not be powered on to the ready stage.	Change with a new battery. If the message reappears, contact the retailer for service.
<b>Low Battery</b>	Low battery: Battery icon is flashing, still can be measurable.	Suggest to replace the battery.
<b>Dead Battery</b>	Dead battery: Battery icon always flashing, still can be measurable.	Replace the battery

Specification	Temple temperature mode	Object mode
Temperature measurement range	Temple temperature mode: 34~42.2°C (93.2~108°F) Object mode: 0~99.9°C (32~199.9°F)	For temple temperature mode: ±0.3°C (0.5°F) during 34~42.2°C (93.2~108°F) For object mode: ±2°C or ±3.6°F when measuring the object temperature between 0~99.9°C (or 32~199.9°F)
Accuracy	Temple temperature mode: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%, 700~1060 hPa Object mode: 10~40°C (50~104°F), RH <85%, 700~1060 hPa	±0.3°C (0.5°F) during 34~42.2°C (93.2~108°F)
Operating condition	Temperature: 25~55°C (-13~131°F), RH <85%, 700~1060 hPa	
Storage and transportation condition	Temperature: 25~55°C (-13~131°F), RH <85%, 700~1060 hPa	
Memory	9 set	
Display resolution	0.1	
Battery	AAA x 2	
Weight (without battery)	160g (without battery)	
Size	10.4cm(L) x 5.2cm(W) x 1.57cm(H)	
Auto shutdown	60 sec	
Safety classification	II Type BF equipment	
IP Classification	IP22 Protection against water and dust	

• Dispose of device and batteries according to local regulations  
**Caution**  
1. Only use the device once you have read and understood these instructions for use. Keep the instruction manual for use.  
2. The thermometer and patient needs to stay in the room in which the measurement is taken for at least 30 minutes before use.  
3. It is recommended that you always take the temperature in the same location, since temperature readings may vary according to the locations.  
4. It is recommended that three temperatures are taken and the highest one taken as the reading if:  
a) New born infants  
b) Children with a compromised immune system and for whom the presence or absence of fever is critical.  
c) When the user is learning how to use the thermometer for the first time until he/she has familiarized himself/herself with the instrument and obtains consistent readings.  
d) The reading is extremely low.  
5. Do not take a measurement while drinking, eating, sweating or exercising.  
6. Do not take measurement while or immediately after nursing.  
7. Children is not allowed to use the device. Medical products are not toys.  
8. Influences on body temperature  
a) A person's individual metabolism  
b) Age: Greater temperature fluctuations occur faster and more often in children. Normal body temperature decreases with age.  
c) Clothing  
d) Outside temperature  
e) Time of day: Body temperature is lower in the morning and increases throughout the day towards evening.  
f) Activities: Physical and, to a lesser extent, mental activities increase body temperature.  
9. This device is not shock-protected. Do not drop or expose to heavy shock this device.  
10. Do not bend the device.  
11. Do not disassemble or make modifications to the device.  
12. Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at your local retailer or at appropriate collection points provided in your country.  
13. Do not boil the probe.  
14. Do not use the device if it operates irregularly or any error message showed.  
15. Do not use thinner or benzene to clean the device.  
16. Wipe the device clean before storing.  
17. When take the device from storage at below or above 16~40°C(60.8~104°F), place it in 16~40°C(60.8~104°F) temperature range for at least 30 minutes before use.  
18. Remove the battery if the device will not be used for a long time.  
19. If this device is used according to the operation instruction, periodic re-calibration is not required. If you still have questions, please send the complete device to dealers.  
20. Do not use this device for diagnosis or treatment of any health problem on disease. Measurement results are for reference only. Contact your physician if you have or suspect any medical problems. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.  
21. This device may not meet its performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in specifications.  
22. Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.  
23. Batteries can be fatal if swallowed. You should therefore store the batteries and products where they are inaccessible to children. If a battery has been swallowed, call a doctor immediately.  
24. Be sure to consult a doctor if you feel that your health is in poor condition.  
25. Do not judge your health only on the presence or absence of a fever.  
26. Do not service or maintain device while in use.  
27. This product is certified as a medical device in the European Union under the Medical Device Directive 93/42/EEC by SGS CE1639, exclusively for the indications of human body temperature. Other non-medical uses ascribed to this device have not been evaluated by SGS and are not within the scope of CE certification. Users should be aware that product performance and/or safety has not been evaluated by SGS for those purposes.

**ES Español Introducción**  
El termómetro temperatura de la sien sin contacto de Rossmax utiliza un detector infrarrojo para detectar la temperatura corporal en la sien de adultos y niños en casa, hospital, hogar o lugar público. Este termómetro puede detectar la temperatura de un objeto.  
La calidad del termómetro temperatura de la sien infrarrojo ha sido verificada y está en conformidad con las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE del Consejo de la CE (directiva de productos sanitarios) Anexo I relacionada con los requisitos esenciales del producto, y las normas armonizadas aplicadas. Conformidad con ASTM E1965-98(2016).  
Este termómetro convierte la temperatura en la sien de tal manera que se visualiza su "equivalente oral" (en conformidad con la evaluación clínica).  
Por favor, lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar el producto y asegúrese de guardarlo en un lugar seguro.

**Funcionamiento**  
El termómetro ha sido diseñado para el uso práctico. No ha sido concebido para ser un sustituto de un diagnóstico médico. Por favor, acuérdesse también de comparar el resultado de la medición con su temperatura corporal regular.  
El modo de objeto muestra las temperaturas superficiales reales, que es diferente de la temperatura corporal. Ayudará a controlar si la temperatura de algún objeto es apropiada para el bebé o el paciente, por ejemplo la leche para el bebé.  
Si el termómetro detecta una temperatura corporal >37.5°C (99.5°F), sonará cuatro tonos para advertir al usuario de una posible fiebre.  
**Temperatura en la sien**  
El modo de medición de temperatura corporal regular.  
**Modo de objeto**  
El modo de objeto muestra las temperaturas superficiales reales, que es diferente de la temperatura corporal. Ayudará a controlar si la temperatura de algún objeto es apropiada para el bebé o el paciente, por ejemplo la leche para el bebé.  
**Alarma de fiebre**  
Si el termómetro detecta una temperatura corporal >37.5°C (99.5°F), sonará cuatro tonos para advertir al usuario de una posible fiebre.

**Configuración de su termómetro**  
1. Abra la cubierta de la pila.  
2. Presione el botón de "ON/OFF/Memory" para encender el termómetro.  
3. Entre en la configuración presionando el botón de "MODE" para seleccionar el modo de medición de temperatura en la sien, consulta la escala de temperatura: Celsius/Fahrenheit; y sonido bip, seguidamente en este orden.  
4. Cambie el modo de medición de la sien a un objeto pulsando el botón "Q". El icono de modo de medición aparecerá en pantalla acorde al modo que seleccione.  
5. Cambie la escala de "C a F" presionando el botón "MODE". Presione el botón "Q" para cambiar a la escala de medición correspondiente. Al configurar otra escala de medición, el icono de modo de medición en la pantalla también cambiará.  
6. Después de ajustar el modo de medición y la escala, pulse de nuevo el botón "Q" para pasar al siguiente ajuste del sonido bip.  
7. Ajuste el sonido bip como se describe anteriormente, utilizando el botón "Q" para elegir activar el sonido bip (b1/on) o desactivarlo (b1/DF).8. Su termómetro está preparado para la medición después de aparecer en la pantalla todos los símbolos o pulsando el botón ON/OFF/Memory otra vez.  
Nota:  
• La configuración inicial o según el valor por defecto es en modo de medición en la sien, escala "C" y sonido de bip activado.

**Modo de medir la temperatura en la sien**  
1. Asegúrese siempre de que la punta está limpia y no muestra ningún daño.  
2. Presione el botón de "ON/OFF/Memory" para encender el termómetro.  
3. Asegúrese antes de tomar la temperatura de que el icono del modo de medición es muestra en la pantalla.  
4. Apunte el termómetro al centro de la siena a una distancia de menos de 10 cm. Si la sien está cubierta de cabello, sudor o suciedad, elimine el obstáculo de la sien para mejorar la exactitud de medición.  
5. Presione el gatillo de medición para tomar la temperatura. La medición habrá concluido si oye un tono prolongado.  
6. Lea la temperatura registrada en la pantalla LCD.  
**Modo de medir la temperatura de objetos**  
1. Presione el botón de "ON/OFF/Memory" para encender el termómetro.  
2. Asegúrese antes de tomar la temperatura de que el icono del modo de medición es muestra en la pantalla.  
3. Una vez que apuntan al objeto a medir, presiona el botón "Measuring Trigger" para tomar la temperatura. La medición se completa cuando se oye un bip largo.  
4. Lea la temperatura registrada en la pantalla LCD.  
Nota:  
1. Las aplicaciones incluyen unas mediciones de la temperatura de agua, leche, ropa, piel u otros objetos.  
2. Este modo muestra las temperaturas superficiales reales, sin ajustar, las cuales son diferentes a la temperatura corporal.  
**Función de memoria**  
Existen un total de 9 memorias ajustadas para la medición de la temperatura corporal. Si la lectura del termómetro está dentro del rango de temperatura normal de 34°C a 42.2°C (de 93.2°F a 108°F), al apagarse el termómetro, los últimos datos de medición serán guardados en la memoria.  
• Presione el botón "ON/OFF/Memory" repetidamente para revisar las mediciones almacenadas en la memoria

**Cuidado y limpieza**  
1. Rango de temperatura de almacenamiento: Debería ser guardado a una temperatura ambiente de -25 a +55°C (-13°F ~ 131°F), RH <85%, 700-1060hPa.  
2. Mantenga la unidad seca y alejada de cualquier líquido o de la exposición directa al sol.  
3. La punta no deberá ser sumergida en algún líquido.  
4. Por favor, examine el aparato con respecto a daños si se ha caído. Si no está seguro, envíe el aparato completo al distribuidor más cercano para una nueva calibración.  
5. Sosteniendo el termómetro durante un tiempo demasiado prolongado podrá causar una lectura más alta de la temperatura ambiente. Lo mismo ocurrirá leyendo en una medición de la temperatura corporal más baja de lo normal. Intente no tocar la parte de la sonda del termómetro para evitar una lectura incorrecta.  
6. No desarme el aparato, ni realice cambios en él.  
7. Por favor, no deseché el producto en las basuras domésticas al terminar su vida útil. Es posible deshecharlo con su distribuidor local o en algún punto de recolección preestablecido para ello en su país.  
8. No hierva la punta.  
9. No use el aparato si funciona de modo anormal o si se visualiza algún mensaje de error.  
10. No use ningún diluyente o benceno para limpiar el aparato.  
11. Limpie el aparato con un trapo antes de guardarlo.  
12. Si el aparato ha estado guardado a temperaturas abajo de o por encima de 16~40°C (60.8~104°F), expóngalo a un rango de temperatura de 16~40°C (60.8~104°F) durante un mínimo de 30 minutos antes de usarlo.  
13. Saque la pila del aparato si no va a usar el mismo durante un período prolongado.  
14. Si el aparato es usado según las instrucciones para el manejo, no se requerirá ningún recalibración periódico. En caso de dudas, por favor envíe el aparato completo al distribuidor.  
15. No use el aparato para diagnósticos o tratamientos en caso de algún problema de salud o alguna enfermedad. Los resultados de medición únicamente servirán de referencia. Póngase en contacto con su médico en caso de tener o sospechar algún problema médico. No cambie su medicación sin consultar a su médico o profesional de atención a la salud.  
16. Es posible que el aparato no cumpla con las especificaciones de funcionamiento si es guardado o usado fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados en ESPECIFICACIONES.  
17. La pila no deberá ser cargada o ser expuesta a calor extremo ya que podría explotar.  
18. Las pilas son residuos peligrosos. No las tire junto con la basura doméstica.  
19. En el interior no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. La garantía no cubre las pilas o los daños causados por pilas viejas.  
20. Use únicamente pilas de marca. Sustituya siempre todas las pilas juntas. Use pilas de la misma marca y del mismo tipo.  
**Localización de fallos**

Error	Problema	Remedio
EE	El sistema no está funcionando adecuadamente.	Saque la pila, espere 1 minuto y vuelva a meterla. Si el mensaje vuelve a aparecer, contacte al distribuidor para un servicio postventa. Deje que el termómetro permanezca por lo menos 30 minutos en un lugar a temperatura ambiente: para el modo de temple: 16 ~ 40 °C (60 ~ 104 °F) para el modo de objeto: 10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F).
EI	Exceso del rango de temperatura de funcionamiento	

**Hi**  
(1) En el modo de la sien: La temperatura medida es más alta que 42.2°C (108.0°F).  
(2) En el modo de objeto: La temperatura medida es más alta que 99.9°C (199.9°F).

**Lo**  
(1) En el modo de la sien: La temperatura medida es más baja que 34°C (93.2°F).  
(2) En el modo de objeto: La temperatura medida es más baja que 0°C (32°F).

**Low Battery**  
(1) La pila está baja y ya no es posible realizar más mediciones.  
(2) La pila va a agotarse pronto y es necesario reemplazarla.

**Dead Battery**  
(1) La pila está agotada y ya no es posible realizar más mediciones.  
(2) La pila va a agotarse pronto y es necesario reemplazarla.

**Especificación**  
Rango de medición de temperatura: En el modo de la sien: 34~42.2°C (93.2~108°F)  
En el modo de objeto: 0~99.9°C (32~199.9°F)  
En el modo de la sien: ±0.3°C (0.5°F) durante 34~42.2°C (93.2~108°F).  
En el modo de objeto: ±2°C or ±3.6°F a temperatura ambiente 0~99.9°C (or 32~199.9°F).  
Exactitud: En el modo de la sien: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%, 700~1060 hPa  
En el modo de objeto: 10~40°C (50~104°F), RH <85%, 700~1060 hPa  
Rango de temperatura de almacenaje: 25~55°C (-13~131°F), RH <85%, 700~1060 hPa  
9 ajustadas  
Resolución de la pantalla: 0.1  
Batería: AAA x 2  
Peso: 160g (sin pilas)  
Dimensiones: 10.4cm(L) x 5.2cm(A) x 1.57cm(H)  
Apagado automático: 60s.  
Clasificación de seguridad: II Type BF equipment  
Clasificación IP: IP22 Protección contra proyecciones de agua y partículas.

**Precaución**  
1. Únicamente use el aparato si ha leído y entendido estas instrucciones para el uso. Guarde el manual de instrucciones para su uso.  
2. El termómetro y el paciente deberán permanecer en el recinto, en el cual se realizará la medición, por lo menos 30 minutos antes de la misma.  
3. Se recomienda realizar la medición siempre en el mismo lugar porque las lecturas de temperatura podrán variar en función de los lugares.  
4. Se recomienda medir tres temperaturas y tomar la más alta como lectura en los siguientes casos:  
a) Recién nacidos  
b) Niños con un sistema inmunológico deficiente y para los cuales la presencia o la falta de fiebre es una situación crítica.  
c) Usuarios aprendiendo a usar el termómetro por primera vez hasta que se hayan familiarizado con el instrumento y obtengan lecturas consistentes.  
d) Lecturas extremadamente bajas.  
5. No realice ninguna medición al estar bebiendo, comiendo o haciendo ejercicio, o después de ello.  
6. No realice ninguna medición al dar el pecho o inmediatamente después.  
7. Queda prohibido que niños usen el aparato. Los productos médicos no son juguetes.  
8. Influencias en la temperatura corporal  
a) El metabolismo individual de la persona  
b) La edad: Unas fluctuaciones mayores o curren más rápidamente y más frecuentemente en niños. La temperatura corporal disminuye al aumentar la edad.  
c) La ropa  
d) La temperatura exterior  
e) La hora del día: La temperatura corporal es más baja en la mañana y aumenta durante el día hasta la noche.  
f) Las actividades: Cualquier actividad física y, menos intensamente, mente existen un total de 9 memorias ajustadas para la medición de la temperatura corporal. Si la lectura del termómetro está dentro del rango de temperatura normal de 34°C a 42.2°C (de 93.2°F a 108°F), al apagarse el termómetro, los últimos datos de medición serán guardados en la memoria.  
9. Presione el botón "ON/OFF/Memory" repetidamente para revisar las mediciones almacenadas en la memoria

**Cuidado y limpieza**  
1. Rango de temperatura de almacenamiento: Debería ser guardado a una temperatura ambiente de -25 a +55°C (-13°F ~ 131°F), RH <85%, 700-1060hPa.  
2. Mantenga la unidad seca y alejada de cualquier líquido o de la exposición directa al sol.  
3. La punta no deberá ser sumergida en algún líquido.  
4. Por favor, examine el aparato con respecto a daños si se ha caído. Si no está seguro, envíe el aparato completo al distribuidor más cercano para una nueva calibración.  
5. Sosteniendo el termómetro durante un tiempo demasiado prolongado podrá causar una lectura más alta de la temperatura ambiente. Lo mismo ocurrirá leyendo en una medición de la temperatura corporal más baja de lo normal. Intente no tocar la parte de la sonda del termómetro para evitar una lectura incorrecta.  
6. No desarme el aparato, ni realice cambios en él.  
7. Por favor, no deseché el producto en las basuras domésticas al terminar su vida útil. Es posible deshecharlo con su distribuidor local o en algún punto de recolección preestablecido para ello en su país.  
8. No hierva la punta.  
9. No use el aparato si funciona de modo anormal o si se visualiza algún mensaje de error.  
10. No use ningún diluyente o benceno para limpiar el aparato.  
11. Limpie el aparato con un trapo antes de guardarlo.  
12. Si el aparato ha estado guardado a temperaturas abajo de o por encima de 16~40°C (60.8~104°F), expóngalo a un rango de temperatura de 16~40°C (60.8~104°F) durante un mínimo de 30 minutos antes de usarlo.  
13. Saque la pila del aparato si no va a usar el mismo durante un período prolongado.  
14. Si el aparato es usado según las instrucciones para el manejo, no se requerirá ningún recalibración periódico. En caso de dudas, por favor envíe el aparato completo al distribuidor.  
15. No use el aparato para diagnósticos o tratamientos en caso de algún problema de salud o alguna enfermedad. Los resultados de medición únicamente servirán de referencia. Póngase en contacto con su médico en caso de tener o sospechar algún problema médico. No cambie su medicación sin consultar a su médico o profesional de atención a la salud.  
16. Es posible que el aparato no cumpla con las especificaciones de funcionamiento si es guardado o usado fuera de los rangos de temperatura y humedad especificados en ESPECIFICACIONES.  
17. La pila no deberá ser cargada o ser expuesta a calor extremo ya que podría explotar.  
18. Las pilas son residuos peligrosos. No las tire junto con la basura doméstica.  
19. En el interior no existe ninguna pieza que requiera mantenimiento. La garantía no cubre las pilas o los daños causados por pilas viejas.  
20. Use únicamente pilas de marca. Sustituya siempre todas las pilas juntas. Use pilas de la misma marca y del mismo tipo.  
**Localización de fallos**

Error	Problema	Remedio
EE	El sistema no está funcionando adecuadamente.	Saque la pila, espere 1 minuto y vuelva a meterla. Si el mensaje vuelve a aparecer, contacte al distribuidor para un servicio postventa. Deje que el termómetro permanezca por lo menos 30 minutos en un lugar a temperatura ambiente: para el modo de temple: 16 ~ 40 °C (60 ~ 104 °F) para el modo de objeto: 10 ~ 40 °C (50 ~ 104 °F).
EI	Exceso del rango de temperatura de funcionamiento	

**Hi**  
(1) En el modo de la sien: La temperatura medida es más alta que 42.2°C (108.0°F).  
(2) En el modo de objeto: La temperatura medida es más alta que 99.9°C (199.9°F).

**Lo**  
(1) En el modo de la sien: La temperatura medida es más baja que 34°C (93.2°F).  
(2) En el modo de objeto: La temperatura medida es más baja que 0°C (32°F).

**Low Battery**  
(1) La pila está baja y ya no es posible realizar más mediciones.  
(2) La pila va a agotarse pronto y es necesario reemplazarla.

**Dead Battery**  
(1) La pila está agotada y ya no es posible realizar más mediciones.  
(2) La pila va a agotarse pronto y es necesario reemplazarla.

**Especificación**  
Rango de medición de temperatura: En el modo de la sien: 34~42.2°C (93.2~108°F)  
En el modo de objeto: 0~99.9°C (32~199.9°F)  
En el modo de la sien: ±0.3°C (0.5°F) durante 34~42.2°C (93.2~108°F).  
En el modo de objeto: ±2°C or ±3.6°F a temperatura ambiente 0~99.9°C (or 32~199.9°F).  
Exactitud: En el modo de la sien: 16~40°C (60.8~104°F), RH <85%, 700~1060 hPa  
En el modo de objeto: 10~40°C (50~104°F), RH <85%, 700~1060 hPa  
Rango de temperatura de almacenaje: 25~55°C (-13~131°F), RH <85%, 700~1060 hPa  
9 ajustadas  
Resolución de la pantalla: 0.1  
Batería: AAA x 2  
Peso: 160g (sin pilas)  
Dimensiones: 10.4cm(L) x 5.2cm(A) x 1.57cm(H)  
Apagado automático: 60s.  
Clasificación de seguridad: II Type BF equipment  
Clasificación IP: IP22 Protección contra proyecciones de agua y partículas.

**Precaución**  
1. Únicamente use el aparato si ha leído y entendido estas instrucciones para el uso. Guarde el manual de instrucciones para su uso.  
2. El termómetro y el paciente deberán permanecer en el recinto, en el cual se realizará la medición, por lo menos 30 minutos antes de la misma.  
3. Se recomienda realizar la medición siempre en el mismo lugar porque las lecturas de temperatura podrán variar en función de los lugares.  
4. Se recomienda medir tres temperaturas y tomar la más alta como lectura en los siguientes casos:  
a) Recién nacidos  
b) Niños con un sistema inmunológico deficiente y para los cuales la presencia o la falta de fiebre es una situación crítica.  
c) Usuarios aprendiendo a usar el termómetro por primera vez hasta que se hayan familiar